




## 超声乳化手术刀

### 精选Ⅱ型手术刀

Stylus™ 精选Ⅱ型允许直线平滑穿刺，而无组织阻力。

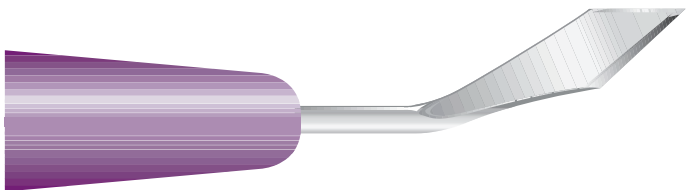


手术刀	描述
52-2231	2.2mm, 弯头 全刀柄 双面刃
52-2431	2.4mm, 弯头 全刀柄 双面刃
52-2531	2.5mm, 弯头 全刀柄 双面刃
52-2631	2.65mm, 弯头 全刀柄 双面刃
52-2831	2.8mm, 弯头 全刀柄 双面刃



# 超声乳化手术刀

## 精选 I 型手术刀

Stylus™ 精选 I 型可以轻易穿透组织，同时切割出一个宽度精确的切口，从而完全匹配超声乳化尖端。

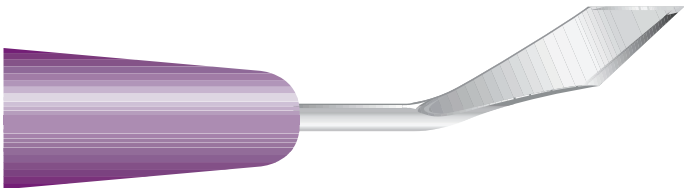


手术刀	描述
52-2561	2.5mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-2661	2.65mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-2761	2.75mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-2861	2.85mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-2961	3.0mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-3261	3.2mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）
52-2662	2.65mm, 弯头 刀头 单面刃（朝上）

## ▶ 超声乳化手术刀

### 穿刺刀 平行侧边

具有平行侧边的 Stylus™ 穿刺刀设计用于进出伤口期间在需要的宽度切割组织。

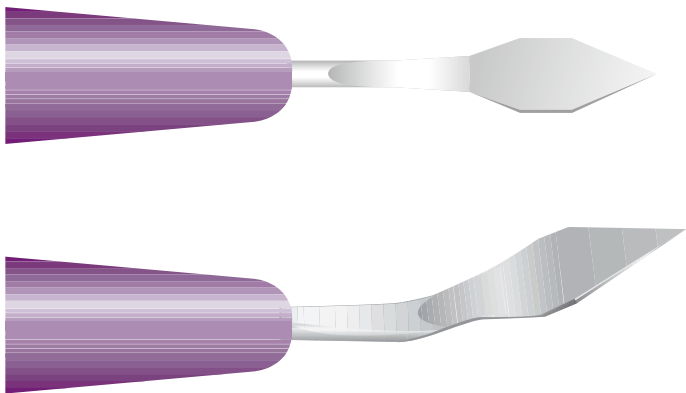


手术刀	描述
52-3212	3.2mm, 弯头 全刀柄 单面刃（朝上）

## ▶ 超声乳化手术刀

### 穿刺刀

Stylus™ 穿刺刀可以轻易穿透组织，同时切割出一个宽度精确的切口，从而完全匹配超声乳化尖端。

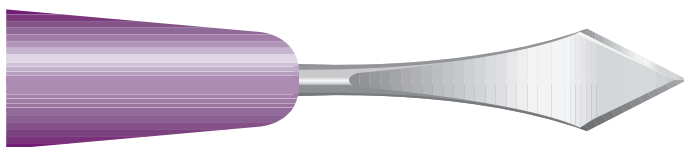

手术刀	描述
52-2801	2.85mm, 直头 全刀柄